



Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием, рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт) перед эксплуатацией.
Сохраните руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Столик для забора крови СЗК-«ДЗМО» (далее - столик) предназначен для удобства забора крови или внутривенных манипуляций в кабинетах медицинских и лечебно-профилактических учреждений.

Столик изготавливают в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444 в соответствии с требованиями ТУ 9452-060-07614107-2012.

2. Технические характеристики

Таблица 1

Длина	550 ± 50 мм
Ширина	370 ± 50 мм
Высота	900 ± 20 мм
Масса	10 кг
Предельная рабочая нагрузка на столик, не более	30 кг
Средний срок службы, не менее	5 лет

ВНИМАНИЕ!

Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного уведомления в связи с постоянным усовершенствованием и улучшением данного изделия.

3. Комплектность

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Количество, штук
1	Столик для забора крови СЗК-«ДЗМО»	1
Эксплуатационная документация		
2	Руководство по эксплуатации (паспорт)	1

Примечание:

Допускается поставка в разобранном виде, крепежные изделия при этом устанавливаются в местах их креплений или уложенные в отдельный пакет.

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указания мер безопасности

4.1. Столик для забора крови, изображенный на рисунке 1, имеет каркас, выполненный из стальных труб, с нанесением полимерно-порошкового покрытия и состоит из двух боковин 1 и двух стяжек 2.

4.2. Верхняя часть - панель 3 выполнена из ДСП, поролона и обтянута искусственной кожей.

4.3. Столик установлен на четыре регулируемые опоры 4, что обеспечивает устойчивое положение даже на неровном полу.

4.4. Порядок сборки столика:

4.4.1. Для подготовки к работе, распакуйте и очистите от упаковочного материала, удалите антикоррозионную смазку протиранием насухо тампоном из марли, смоченным спиртом.

4.4.2. Возьмите боковины 1, закрепите на них верхнюю часть - панель 3 при помощи болтов с шайбами согласно рисунка 1. Затем установите две стяжки при помощи болтов с шайбами. Закрепите регулируемые опоры 4 на соответствующие места к боковинам 1 и законтрите соединение гайками М8. Все разъемные соединения должны быть прочно затянуты. Выполните санитарную обработку столика.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования"

изменениями организаций или филиалов, или структурными подразделениями, принадлежащими к концерну
Зарегистрировано в Межрайонной инспекцией Федеральной Налоговой Службы № 4 по Нижегородской области, дата
регистрации 21.10.2002, (ИНН: 102201615205

сведения о реквизитах организаций или юридических единиц концерна: наименование регистрирующего органа, дата регистрации, регистрационный номер:
Адрес: 607033, Российская Федерации, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Промышленный район
№19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №601, Фактический адрес: 607033, Российская Федерация, Нижегородская
область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Промышленный район №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №601,
телефон: +78317748062, факс: +78317748062

адрес, телефон, факс

в лице Генерального директора Кострова Андрея Владимировича

заявляет, что Тумбочки приведенные в ТП и ТИ-1 по ТУ 9452-023-07614107-2012;

Штаты для длительных инфузий на трех опорах ЦШ-«ДЗМО» по ТУ 9452-004-07614107-99; Ширины однотрехсекционные с полимерными полотнищами, для кабинетов и палат лечебно-профилактических учреждений ЦШ 1/3-«ДЗМО»
по ТУ 9452-007-07614107-99; Набор медицинской мебели для процедурных кабинетов по ТУ 9452-060-07614107-2012 (состав:
полка для ящиков, ПТ-«ДЗМО»; подставка для стерилизационных коробок (боксов), ПСК-«ДЗМО»; столик для забора крови,
СЗК-«ДЗМО»; стул медицинский, СМ-1 «ДЗМО»; табурет медицинский, ТМ-1 «ДЗМО». Приналежности: подставки для ног,
тканевая пружина);

изменениями, что, когда пропускается декларация,

Серийный выпуск, код ОКП 945210

изменения и серийный выпуск или партия (номер партии, номер ящика), реквизиты договора (контракта), наименование, код ОК 085-93 и (или) ТН ВЭД ТС или ОК
90-93 (OKP)

Изготовитель: Акционерное общество "Досчатинский завод медицинского оборудования", Адрес: 607033, Российской
Федерации, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое, Промышленный район №19, участок «ДЗМО», здание
№1, помещение №601, Фактический адрес: 607033, Российской Федерации, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий
поселок Досчатое, Промышленный район №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №601, телефон: +78317748062

изменениями изготовителя, страны и т.д.)

соответствует требованиям ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3, 4)

(обязательные нормативные документы, соответствие которым подтверждено

данной декларацией, с указанием путей технических документов, содержащих требования для данной продукции)

Декларация приват на основании: Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 13485-
2011 (ISO 13485:2003) Рег. № СДСГК RU.OC06.3/00210 от 03.12.2015 года, выдан Обществом с ограниченной
ответственностью "ДАНТА ЦЕНТР" (Свидетельство Рег. № РОСС RU.3608.0411R00 от 02.11.2013 года, выдано Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии), адрес: 107589, город Москва, улица Краснопресненская, дом 17.
Регистрационные удостоверения №№ ФСР 2010-06821 от 12.12.2015 года, № ФСР 2012/13171 от 12.11.2015 года, № ФСР
2012/13172 от 12.11.2015 года, № ФСР 2012/14093 от 12.11.2015 года, выданы Федеральной службой по надзору в сфере
здравоохранения (РОСЗДРАВНАДЗОР)

информации о документах, являющихся основанием

для принятия декларации

Дата принятия настоящей 11.12.2015

Наименование о соответствии действительна до 10.12.2018

Костров Андрей Владимирович

(имя, фамилия)

Сведения о регистрации декларации о соответствии

Регистрационный номер РОСС RU.0001.11М108. Орган по сертификации продукции ООО "ПромТест"

изменениями о зарегистрированных в реестре организаций, осуществляющих декларацию

адрес: 113255, Москва, ул. Профсоюзная, 91А, стр. 23

Регистрационный номер декларации по ТУ 9452-023-07614107-2012, от 11.12.2015


изменениями о регистрационных номерах деклараций

М.П. Денисова Татьяна Осиновна, заместитель руководителя с
правом подписи - Григорян Александр Сергеевич

(имя, фамилия, должность, место работы, профессия)



4.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 4.5.1. Эксплуатация неисправного столика.
 4.5.2. Самостоятельный ремонт столика неуполномоченными заводом-изготовителем лицами.
 4.5.3. Препятствовать свободному перемещению подвижных механизмов столика во избежание получения травм и увечий.

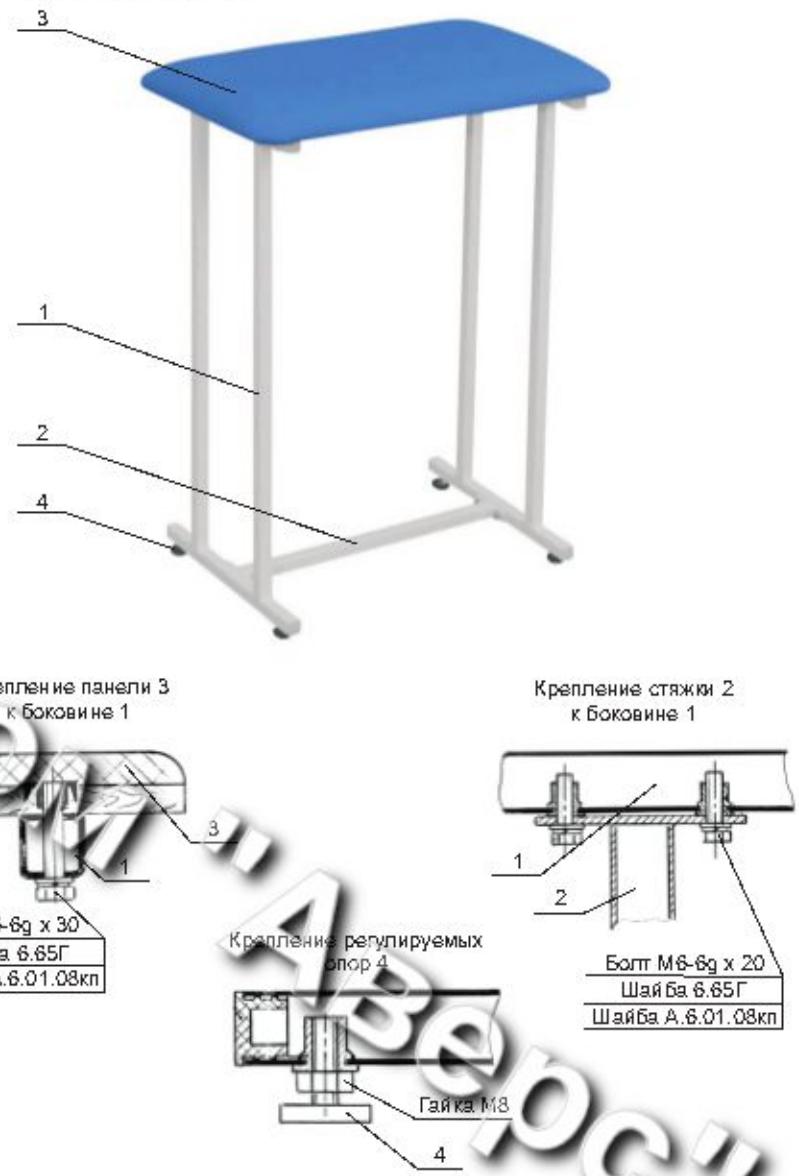

1 - Боковина; 2 - стяжка; 3 - панель; 4 - регулируемая опора.

Рисунок 1

5. Техническое обслуживание

- 5.1. Перед вводом в эксплуатацию и перед использованием расконсервируйте столик промытым мыющим раствором, проверьте отсутствие погнутых деталей, вмятин, коррозии металла, крепление всех болтовых и других видов соединений всех частей столика, убедитесь в надежности фиксирования и крепления, при необходимости закрепите их.
- 5.2. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором хлоромицина по ТУ 6-01-4639387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.
- 5.3. Характерные неисправности столика: ослабление крепежных резьбовых и других элементов. Устраните их подтягиванием или заменой на годные элементы.



Не используйте химические чистящие средства и растворители.
Не применяйте механические приспособления для чистки и дезинфекции.

6. Консервация

- 6.1. Металлические детали столика должны быть предохранены от коррозии в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2°C со сроком переконсервации 3 года (масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01438-87 или К 17 ГОСТ 10877-76).
- 6.2. Столик для забора крови СЗК-“ДЗМО” подвергнут в АО “ДЗМО” консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим условиям ТУ 9452-080-07614107-2012.

Дата	Наименование работы	Срок действия, лет	Должность, фамилия, подпись
	Консервация	3	

7. Транспортирование и хранение

- 7.1. Транспортирование столика должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов транспорта.
 - 7.2. Столик должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°C до плюс 40°C, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°C и при более низких температурах без конденсации влаги.
- Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

8. Сведения об утилизации

Поскольку столик не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

9. Гарантийные обязательства

- 9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
- 9.2. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9452-080-07614107-2012.
- 9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
- 9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.

10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

- 10.1. Истечение гарантийного срока.
- 10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
- 10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
- 10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
- 10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
- 10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.





Акционерное общество
Досчатинский завод
медицинского оборудования



Гарантийные обязательства

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 или 24 месяца при хранении и эксплуатации товара в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет завода-изготовителя.



Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Неправильного заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перевозке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.



Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона. (с голограммой).
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcoome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в полной комплектации.

11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо выполнить следующие действия:

1. Подготовить нам письмо с указанием:
 - наименования товара;
 - даты ввода товара в эксплуатацию;
 - описания дефекта товара и характера неисправности;
 - обстоятельств выявления дефекта;
 - контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту welcoome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих дней.

12. Свидетельство о приемке

Столик для забора крови

Наименование изделия

СЗК-“ДЗМО”

Обозначение

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подпись

число, месяц, год

Сборщик / упаковщик

ООО Торговый дом "Аверс"

Место для
голограммы

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок и голограммы производителя

Наименование
товара

СТОЛИК ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ СЗК-“ДЗМО”

Серийный номер

Дата производства

Гарантийный срок

24 месяца

со дня продажи

Заполняет продающая организация

Наименование
продающей
организации

м.п.

Дата продажи

ФИО / Подпись

Заполняет покупатель

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
К комплектации и внешнему виду
товара претензий не имею.

Наименование
покупателя

м.п.

ФИО / Подпись



Акционерное общество
Досчатинский завод
медицинского оборудования

Производство прочной медицинской техники с 1936 года



ОКП 94 5210

РУ № ФСР 2012/14093 от 12.11.2015 г.

ДС РОСС RU.МН08.Д01691

СТОЛИК ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ СЗК-“ДЗМО”
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)
СЗК.00.00 ПС



Акционерное общество
“Досчатинский завод медицинского оборудования”

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, Рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок “ДЗМО”, здание №1, помещение №001.
тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru